



Audit interne sur la pré-désinfection au bloc obstétrical

B. Mathat¹, F. Gaume¹, M. Herault¹, D. Paillat², A. Chevallereau¹, F. Lemetayer¹, C. Berge-Bouchara¹, C. Airiau¹
¹Stérilisation, ²Hygiène hospitalière, Centre Hospitalier de Cholet

Introduction

Nombreuses non-conformités à réception du matériel pré-désinfecté au bloc obstétrical



Organisation d'un audit

Objectif

Observation étapes et environnement de pré-désinfection



Mise en place d'actions correctives

Matériels et méthodes

Création d'une grille d'audit pour le bloc obstétrical (BO) selon **diagramme d'Ishikawa (6M)** : Main d'œuvre, méthode, milieu, moment, matière et matériel

Création d'une grille d'audit pour la stérilisation


Audit des 2 services sur une **période de 2 semaines**

Auditeurs : interne en pharmacie, infirmière hygiéniste, responsable de flux et pharmacien

Résultats

- 11 grilles observations au bloc obstétrical
- 11 grilles observations en stérilisation

— Point positif (PP)
— Mode de défaillance (MD)

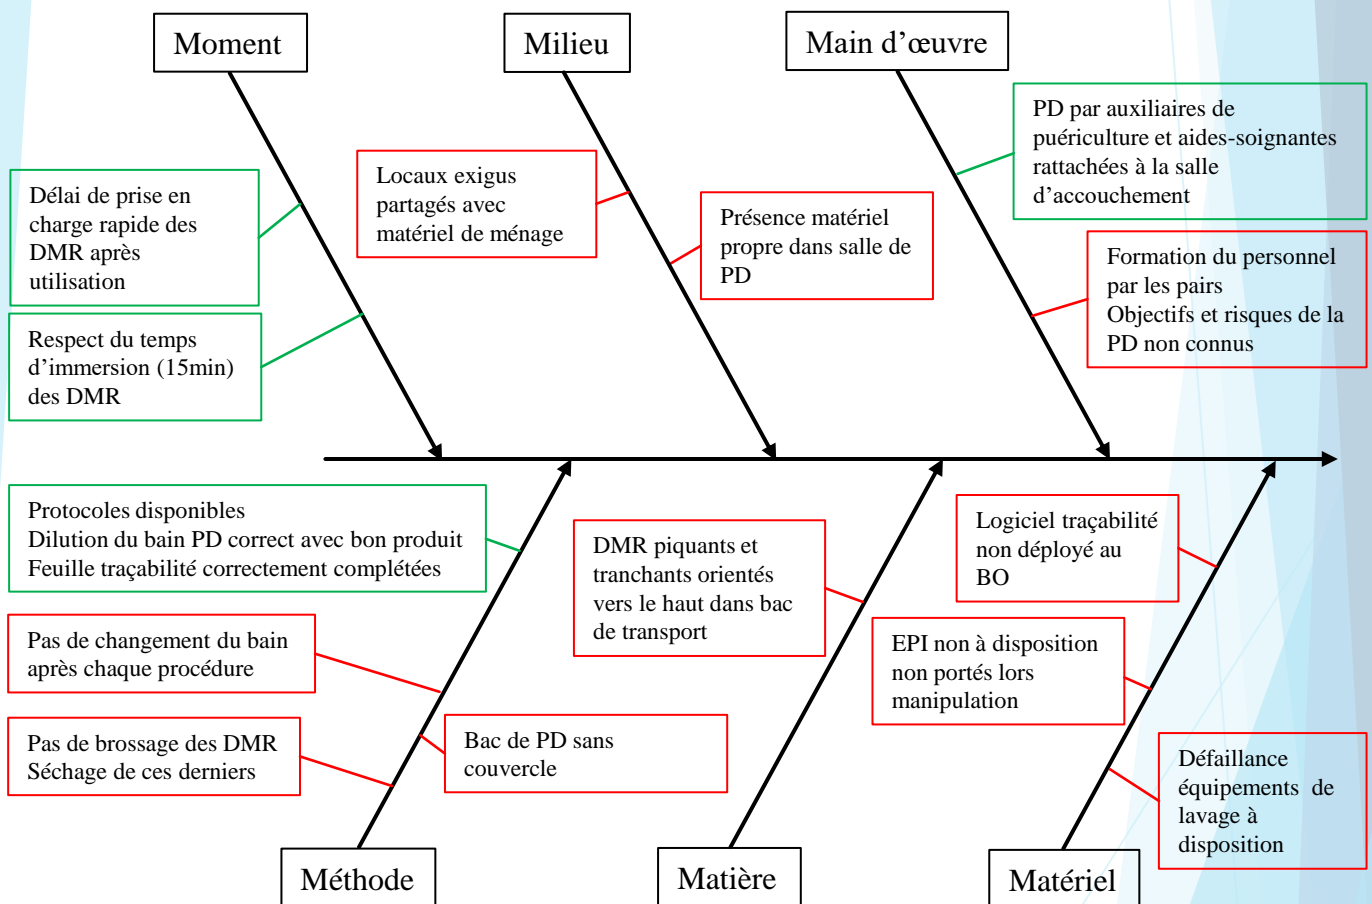

DMR : Dispositifs Médicaux Réutilisables PD : Pré-désinfection EPI : Equipement de Protection Individuelle BO : Bloc Obstétrical

Discussion / Conclusion

Faible taux d'observation dû à une **activité fluctuante**. Modes de défaillances présentés aux équipes du BO avec **mesures correctives**

Equipe dynamique et facilitatrice dans la mise en œuvre de ces changements

Dans la semaine	Dans le mois
<ul style="list-style-type: none"> • Formation théorique et pratique du personnel sur la PD • Achat bacs avec couvercles plus petits et mobiles pour immersion immédiate • Achat et mise à disposition de brosses, écouvillons et EPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement des locaux, optimisation de l'espace disponible • Déploiement du logiciel de traçabilité