

Introduction

- Depuis 2013: Utilisation élevée des DM à UU pour soulager l'activité de l'unité de stérilisation qui prend en charge également un autre établissement de santé
- Mai 2024: Départ d'une partie de l'activité de sous traitance, seule l'étape de stérilisation s'effectue au sein de notre hôpital entraînant un reliquat d'activité
- Fin 2026 : Ouverture du nouveau Lariboisière, un hôpital écoresponsable

Objectif

Réaliser un état des lieux des consommations des DM UU en termes d'unité d'œuvre de stérilisation (UO) afin d'envisager leur réintégration en usage multiple (UM)

Matériels et méthode

- Extraction SAP® des commandes par service sur l'année 2022
- Analyse quantitative

- Visite avec les cadres des réserves des DM
- Vérification des équivalences UM


Comparaison avec l'activité actuelle

- Sélection des instruments chirurgicaux à UU
- Recherche des équivalences en UM

Calcul de l'activité en cas de prise en charge par la stérilisation en équivalent UO (Indicateurs et coûts de la SF2S)

Blocs opératoires

Tous BO confondus, **50 958** instruments chirurgicaux à usage unique dont l'équivalence UM existe (IU) ou kits d'IU ont été commandés.

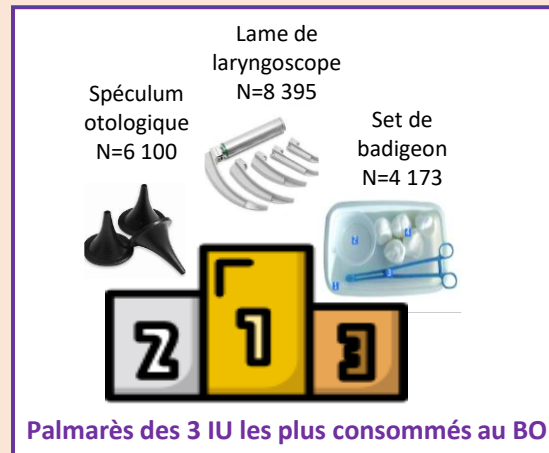

L'activité supplémentaire calculée des BO est de **942 895 UO** en cas de PEC des équivalents des IU soit une augmentation de **27%** par rapport à l'activité de 2022 (3 564 440 UO).


Résultats

Services de soins

- Tous services de soins confondus, **42 437 IU** ont été commandés.
- L'activité supplémentaire calculée est de **600 345 UO** soit **une charge de travail 2,5 fois plus importante** (250 585 UO en 2022),

Activité globale

Estimation de l'activité en stérilisation en cas de PEC de l'UU en UM en 2022 (UO)

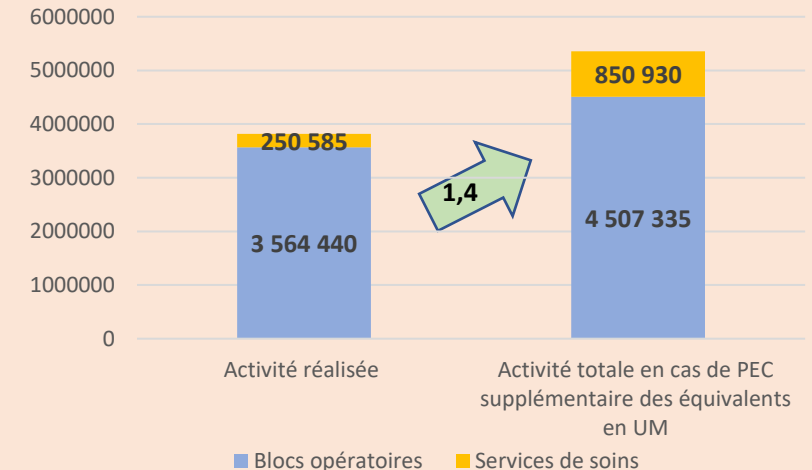

L'activité supplémentaire est de **1 543 240 UO** soit **+ 40%** par rapport à l'activité globale de 2022 (3 815 025 UO).

Discussion / Conclusion

- Il s'agit d'un premier état des lieux des IU au sein de notre hôpital. Cette analyse préliminaire doit être complétée par une analyse économique, écologique, et qualitative en prenant en compte l'avis des utilisateurs.
- La réintégration en UM permettrait de ne plus être impactée par l'imprévisibilité des nombreuses ruptures des DM à UU.